

數位電導度計 CD-4303

中文說明

當您購買這台數字式儀器時，使您進一步踏入精密儀器的領域，雖然這台數位電導度計是一台複雜的且精密的儀器，但假如能正當使用的話，它將可以使用許多年，請詳細閱讀以下說明及注意事項，並且妥善保管這本操作手冊。

A. 規格說明

1. 一般規格

電路	單一微處理 LSI 機體電路.
顯示器	液晶顯示器,字體尺寸 13mm(0.5"),雙視窗幕顯示器.
測量功能	電導度:(3 段測試範圍) 199.9 μ S. 1.999mS. 19.99mS..
	溫度: 0~60°C/32~140°F.
溫度補償	自動溫度補償,範圍 0~60°C. 溫度補償係數可改變式,在 0~5.0%之間,每一°C.
記憶召回	記錄測量中之最大值,最小值及平均值.可記憶召回記錄值.
自動關機	未使用任何按鈕,於十分鐘後自動關機.
資料輸出	RS-232 電腦輸出介面.
過載指示	指示"———"
取樣時間	約 0.8 秒/次.
工作環境溫濕度	溫度:主機 0~50°C,測棒 0~60°C. 濕度須低於 80%R.H.
消耗電流	約直流 7.8 毫安培.
工作電源	006P 9 伏特電池.建議使用高容量電池.
重量	350 公克/0.77 磅.(包含電池)
外觀尺寸	主機:180*72*32 mm. 測棒:圓型直徑 22mm×120mm 長.
標準附件	操作手冊.....1 本. 電導度測棒.....1 只. 攜帶盒.....1 只.
選購附件	應用軟體.....SW-U801 WIN. RS-232 連接線....UPCB-01.

2-2. 電氣規格:

A: 電導


檔位	測量範圍	解析度	精確度	
200 μ S	0.1~199.9 μ S	0.1 μ S	\pm (2%F.S.+1 位數) F.S.-滿刻度	
2mS	0.2~199.9mS	0.001 mS		
20 mS	2~19.99 mS	0.01 mS		

B.溫度

測量範圍	0~60°C/32~140°F.
解析度	0.1°C/0.1°F.
精度	0.8°C/1.5°F.

3.面板說明:

- 3-1 液晶顯示器.
- 3-2 電源開關按鍵.
- 3-3 資料鎖定鍵.(讀值鎖定)
- 3-4 攝氏/華氏單位切換鍵.
- 3-5 顯示器明暗對比調整旋鈕.
- 3-6 記憶記錄鍵.
- 3-7 記憶記錄值召回鍵.
- 3-8 係數調整鍵.(溫度係數整)
- 3-9 測量範圍選擇鍵.
- 3-10 溫度係數設定鍵.
- 3-11 電池槽/電池蓋.
- 3-12 測棒輸入插孔.
- 3-13 RS-232 資料輸出孔.
- 3-14 電極測棒握把.
- 3-15 電導度電極.
- 3-16 電極測棒插頭.

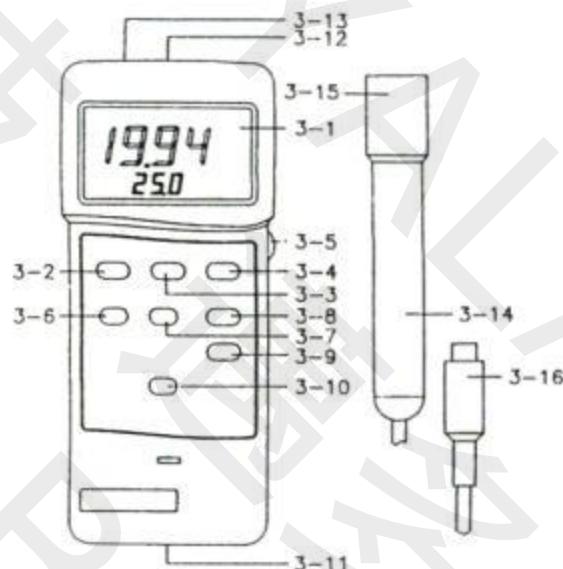

4.測量步驟.

4-1.電導測量.

- (1) 電池裝妥後,按下電源鍵(POWER)開機(圖 3-2)
- (2) 此電導度計採內建式溫度係數補償,調整範圍 0~5%每一°C,出廠溫度補償係數設定為 2%. 當你購買此電導度計後,欲更改補償係數程序如下:
 - a.按"TEMP."鍵(圖 3-10).顯示器將顯示 2.0%
 - P°C.
 - b.按"FACTOR ADJ."鍵(圖 3-8).選擇所需之補償係數.每按一下,增加 0.1%每一°C.
 - c.每當輸入新的補償係數後,必須再按"TEMP."鍵,完成設定.
- (3) 選擇設適用測量範圍,使用"範圍選擇鍵"(圖 3-9).
 - *如顯示器出現"———",表示過載測量,須重選擇較高的測量範圍.
 - *如顯示器出現"____",表示範圍過高,須重選擇較低的測量範圍.
- (4) 將"電導電極"(圖 3-15)浸入被測液中,將測棒約 1 半位置浸入被測液中.
- (5) 液晶顯示器顯示測量值.測量值下方同時溫度值.
 - *按"C/F"鍵(圖 3-4),選擇溫度單位.顯示器出現°C 或°F 單位.*

4-2.資料鎖定.


- * 資料鎖定功能(讀值鎖定):進行測量時如須將測量值鎖定,按"HOLD"鍵(圖 3-3).即可將測量值固定於顯示器上(此時顯示器左上出現"D.H"符號).欲取消時,再按一下 HLD 鍵.

4-3.資料記錄功能:(最大值,最小值,平均值)

- * 按下"RECORD"鍵(圖 3-6),顯示器左下方出現"REC"符號,此時即開始記錄測量中之最大值,最小值,平均值.
- * 當"REC"符號出現於顯示器時.

- a.按"CALL"鍵(圖 3-7),顯示器左方出現"Max"符號,顯示器顯示測量過程中之最大值.
- b.再按"CALL"鍵(圖 3-7) 鍵,顯示器左方出現"Min"符號,顯示器顯示測量過程中之最小值.
- c.再按"CALL"鍵(圖 3-7) 鍵,顯示器左方出現"AVG"符號,顯示器顯示測量過程中之平均值.
- d.如欲取消記錄功能或再進行另一次測量記錄,按下"RECORD"鍵,即可取消記憶記錄功能.
此時顯示器之"REC"符號將消失.

4.4.快捷功能圖表:

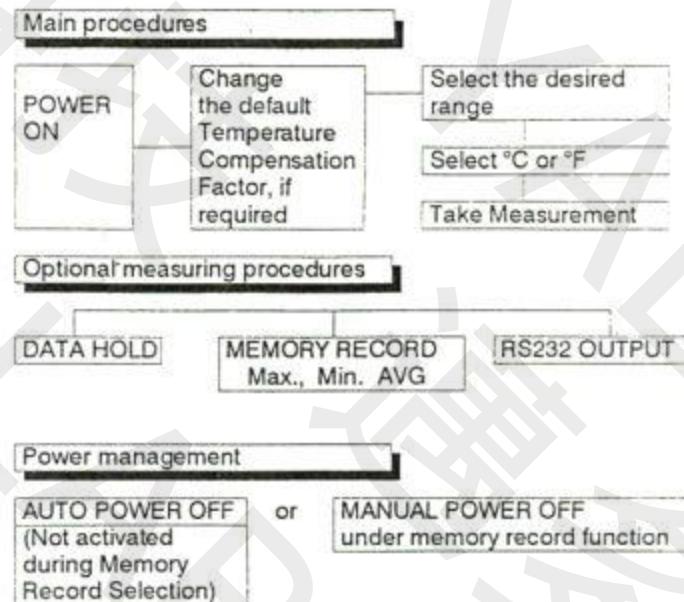


5.補充要點說明:

- (1) 此電導度計內建"自動關機功能",在未按任何功能鍵下,十分鐘後將自動關機以延長電池壽命.
如欲取消自動關機功能,按"RECORD"鍵,則會持續開機.
- (2) 此電導度計顯示器具有明暗對比調整功能,調整旋鈕位於"圖 3-5"位置.

6.校正調整.

此儀錶使用一段時間,或經過長期的測量,無論如何必須作周期性的校正調整程序.因電導電極會因長期使用而有所變化.校正步驟如下:

- (1) 準備"1.413mS"校正溶液.
- (2) 測量範圍檔位選擇在"2mS"檔.
- (3) 將電導電極測棒放至 1.413mS 校正液中.(須輕搖晃幾下,加速極化)
- (4) 調整"校正調整旋鈕"(VR4.如下圖示).位於電池槽內,須打開電池蓋進行調整,然後將顯示器上之顯示值調整至校正溶液相等.(1.413mS)

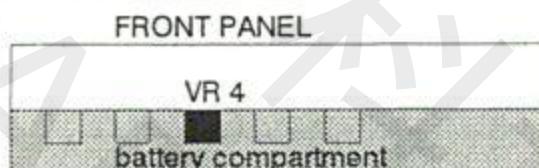

7.RS-232 電腦介面功能.

這儀器特殊介面輸出孔,3.5mm 插頭,16 位元輸出.

8.電池更換.

- 1.當左上角出現"LBT"符號時,代表電池電力不足(電壓 6.5V-7.5V),它將告訴你須更換新電池.
- 2.利用隨身小工具打開電池蓋,更換新電池,在把原有電池蓋蓋上.
- 3.如長時間不操作使用,請將電池取出.